

Revista Estomatológica Herediana

ISSN: 1019-4355

rev.estomatol.herediana@oficinas-
upch.pe

Universidad Peruana Cayetano Heredia
Perú

Castro-Núñez, Gabriela; Escalante-Otárola, Wilfredo; Scapin Viola, Kennia; Coaguila-Llerena, Hernán; Faria, Gisele; Kuga, Milton Carlos

Comparación del sistema ProTaper Universal con homólogo adulterado: estudio descriptivo

Revista Estomatológica Herediana, vol. 26, núm. 3, julio-septiembre, 2016, pp. 184-190
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421548381011>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

Comparación del sistema ProTaper Universal con homólogo adulterado: estudio descriptivo

Comparison of ProTaper Universal system with adulterated homologous: descriptive study

Gabriela Castro-Núñez^{1,a}, Wilfredo Escalante-Otárola^{1,a}, Kennia Scapin Viola^{1,a}, Hernán Coaguila-Llerena^{2,b}, Gisele Faria^{1,c}, Milton Carlos Kuga^{1,c}

RESUMEN

Objetivos: Describir las características macroscópicas, microscópicas y la caracterización del material de instrumentos rotatorios de Níquel-Titanio (NiTi), ProTaper Universal, en comparación con instrumentos similares de dudosa procedencia. **Material y métodos:** El análisis macroscópico se realizó a través de fotografía macro de las cajas e instrumentos. Para el análisis microscópico, se utilizaron los instrumentos S1 y F1, los cuales fueron seccionados y analizados a través de microscopía electrónica de barrido comparando partes activas y secciones transversales con magnificación de 500X y 400X. Adicionalmente, se realizó la caracterización de los fragmentos, a través de microanálisis por dispersión de energías de rayos-X (EDX). **Resultados:** Al análisis macroscópico, las cajas de los sistemas presentaron diferencias en el diseño y especificaciones, los vástagos de los instrumentos presentaron diferencias de forma, color y acabado, y las partes activas de algunos instrumentos, presentaron diferencias de diámetro, forma y acabado. Al análisis microscópico, los instrumentos adulterados presentaron ángulos de corte menos afilados y ausencia de convexidades triangulares. Al comparar la composición química de los instrumentos, el análisis **EDX Resultados:** mostró que ambos instrumentos tienen una composición Ni-Ti similar. **Conclusiones:** Las mayores diferencias entre el sistema ProTaper Universal y su homólogo adulterado, se presentaron en el análisis macroscópico. El análisis microscópico presentó diferencias principalmente en el formato de la sección transversal.

PALABRAS CLAVE: Endodoncia, instrumentos dentales, preparación del conducto radicular, fotografía, microscopía electrónica.

SUMMARY

Objectives: To describe the macroscopic, microscopic characteristics and material characterization instruments rotary nickel titanium (NiTi) ProTaper Universal compared to similar instruments of dubious origin. **Material and methods:** Macroscopic analysis was performed using macro photography boxes and instruments. For microscopic analysis, S1 and F1 instruments were used, which were sectioned and analyzed by scanning electron

¹ Programa de Posgraduación en Odontología, Facultad de Odontología de Araraquara, Universidad Estatal Paulista. São Paulo, Brasil.

² Facultad de Estomatología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

^a Magister en Odontología

^b Especialista en Endodoncia

^c Profesor adjunto

microscopy comparing active parts and cross sections 500X and 400X magnification. Additionally, the characterization of the fragments was performed by energy dispersive microanalysis of (EDX) X-rays. **Results:** At the macroscopic analysis, boxes systems differed in design and specifications, the shanks of the instruments showed differences in shape, color and finish, and the active parts of some instruments, showed differences in diameter, shape and finish. Microscopic analysis, adulterated instruments showed less sharp cutting angles and absence of triangular convexities. By comparing the chemical composition of the instruments, the EDX analysis showed that both instruments have a composition Ni-Ti like. **Conclusions:** The major differences between ProTaper Universal system and its counterpart adulterated, were presented at the macroscopic analysis. Microscopic analysis showed differences mainly in the form of the cross section.

KEYWORDS: *Endodontics, Ni-Ti, photography, microscopy, x-ray microanalysis.*

INTRODUCCIÓN

Los instrumentos endodónticos fabricados con aleaciones de Níquel-Titánio (NiTi) fueron introducidos en el mercado en 1988, con el objetivo de sustituir la rigidez, o sea el alto módulo de elasticidad de los materiales de acero inoxidable (1-3). Estos instrumentos son de dos a tres veces más flexibles que las limas de acero inoxidable (4). La aleación usada en la fabricación de instrumentos endodónticos consiste en aproximadamente 55% níquel y 45% titanio siendo llamada genéricamente 55-Nitinol (5). Desde entonces han revolucionado los convencionales diseños de los instrumentos, cambiando principalmente las secciones transversales y conicidades, en busca de instrumentos con mayor eficiencia de limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares (6-9).

El NiTi proporciona aumento de la flexibilidad y resistencia a la fractura, características que mejoran el rendimiento de los instrumentos durante la preparación biomecánica de conductos radiculares curvos (10-12). Las razones para la separación de los instrumentos rotatorios de NiTi incluyen variaciones de la anatomía del conducto, tales como fusión, curvaturas, dobles curvaturas, dilaceraciones o conductos divididos (13). Además, factores relacionados con el operador y la capacidad clínica son también importantes para la separación de instrumentos (14).

En 2006, Dentsply Maillefer (Ballaigues, Switzerland) lanzó al mercado el Sistema ProTaper Universal, uno de los más usados y estudiados sistemas rotatorios de NiTi, que es caracterizado por su diseño con conicidad variable a lo largo de su parte activa, convexidad triangular en su sección transversal, y puntas inactivas, disminuyendo con ello la fatiga del instrumento, las cargas de torsión y el potencial de

fractura (15,16).

El Sistema ProTaper Universal tiene un kit básico que contiene: un instrumento SX, especial para preparación cervical o desgaste anticurvatura; dos instrumentos para conformación del conducto, S1 y S2; y tres instrumentos para finalización de la preparación biomecánica, F1, F2 y F3; esta secuencia sirve para la preparación de la mayoría de conductos radiculares (17).

No obstante, comercialmente existen instrumentos rotatorios de similares características, que aparentemente se asemejan al sistema ProTaper Universal, pero que son de dudosa procedencia, pudiendo comprometer la eficiencia de la instrumentación de los conductos radiculares. Por otro lado, no existen estudios que evalúen si estos instrumentos similares son de características macroscópicas, microscópicas y metalográficas iguales a los originales. Por lo tanto, es interesante evaluar comparativamente, con la finalidad de alertar a los endodoncistas clínicos sobre los riesgos de su uso.

Este estudio tiene como objetivo describir las características macroscópicas, microscópicas y de composición de instrumentos rotatorios de NiTi, ProTaper Universal, en comparación con instrumentos similares, de dudosa procedencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis macroscópico se realizó a través de fotografía macro con cámara fotográfica profesional (EOS Rebel T5i; Canon Co., Tokio Japan), objetivo macro (EF 100mm f/2.8L Macro; Canon, Tokio Japan), y flash circular (Macro Ring Lite; Canon Co., Tokio, Japan) en programación específica. La cámara

ra fotográfica fue fijada perpendicularmente al fondo blanco utilizado, sobre el cual fueron posicionados individualmente los elementos descritos (previamente limpiados), para la obtención de las imágenes respectivas.

Para el análisis microscópico, se utilizaron los instrumentos S1 y F1, los cuales fueron seccionados dos veces, a 5mm y 10mm, con máquina de corte (Isomet; Buehler, Lake Bluff, IL). El fragmento correspondiente a la punta del instrumento, fue utilizado para el análisis microscópico de la parte activa, y el fragmento restante, para el análisis microscópico de la sección transversal. Todos los fragmentos, fueron lavados con agua destilada, agitados en ultrasonido (Cristófoli, Campo Mourão, PR, BR) por 10 minutos, y posicionados individualmente en *stubs* metálicos y sin metalizar. Posteriormente se analizaron los fragmentos a través de microscopía electrónica de barrido JEOL 6060 (JEOL Ltda, Tokyo, Japan), operado en 20 kV, comparando partes activas y secciones transversales de los instrumentos, con magnificación de 500X y 400X. Adicionalmente, se realizó la caracterización de los instrumentos a través de microanálisis por dispersión de energías de rayos-X (EDX) (6060; JEOL Ltda, Tokyo, Japan), operado en 20 kV, con los fragmentos de las partes activas utilizados en el análisis microscópico.

RESULTADOS

Análisis macroscópico

Inicialmente, se compararon las cajas de los sistemas ProTaper Universal (Figura 1), encontrándose diferencias en el diseño de las caras frontal y lateral de la caja. En la cara frontal de la caja adulterada, se puede observar la descripción del tipo de instrumento en varios idiomas en la parte superior (Figura 1; B), que no se encuentra en la caja original (Figura 1 (A)); el número de referencia de la parte lateral izquierda termina en 00, siendo que en la caja original termina en 12; además la principal diferencia es la presencia del término “CE 0459” en la parte central (Figura 1 (B; flecha)), como una especificación del producto, que tampoco es observada en la caja original. En la cara lateral de la caja falsa, se puede observar una descripción resumida de los instrumentos (SX-F3) y no la descripción de cada uno en su respectiva posición (S1, S2, F1, F2, F3, SX) como en la caja original (Figura 1 (A)); además se observa la longitud de los

instrumento (25mm), que no está presente en la caja original.

En la comparación macroscópica de los instrumentos SX (Figura 2), se encontraron diferencias principalmente en el vástago del instrumento, como la variación del color dorado metálico y de las tonalidades del amarillo del tope (Figura 2 (A y B)); además se distingue un acabado deficiente a nivel de la conexión del vástago al motor y la presencia de una diferencia de relieves en el vástago (Figura 2 (B; flecha)), que no está presente en el instrumento original. En la parte activa no se encuentran grandes diferencias macroscópicas (Figura 2 (C, D y E)), solo una ligera variación en la tonalidad del metal y la separación de la punta del instrumento (Figura 2 (E)), que ocurrió en su primer uso, revelando su poca resistencia, aparentemente por un diseño y composición que no correspondería al de un instrumento SX original.

La comparación macroscópica del resto de instrumentos fue similar, el vástago adulterado (Figura 3 (B)) presenta una longitud menor, diferencia en el color dorado metálico, deficiencias en el acabado de la conexión del vástago al motor, diferente tonalidad en el color del tope y en el anillo de identificación, además de la diferencia en el formato, siendo que el instrumento adulterado presenta un anillo de identificación cóncavo (Figura 3; B; flecha), cuando el anillo de identificación en el instrumento original es totalmente recto. En la parte activa del instrumento adulterado (Figura 3 (D)), se puede observar una ligera diferencia en el color del metal en comparación con el instrumento original (Figura 3(C)), deficiencia en el acabado, una punta con diámetro mayor y ausencia de estrías, que caracterizan a los instrumentos de mayor calibre del sistema ProTaper Universal (Figura 3 (C)).

Análisis microscópico

La comparación microscópica mostró que los instrumentos S adulterados presentan ángulos de corte menos afilados (Figura 4 (D)) que los instrumentos originales, pero puntas más agudas (Figura 4 (E)); en la sección transversal, los instrumentos adulterados no presentan las convexidades triangulares características (Figura 4(F; flecha)) del sistema ProTaper Universal, modificando el formato macroscópico propio del sistema. Los instrumentos F adulterados también presentan ángulos de corte menos afilados (Figura 5 (D y E)) que los originales; en el corte transversal, los

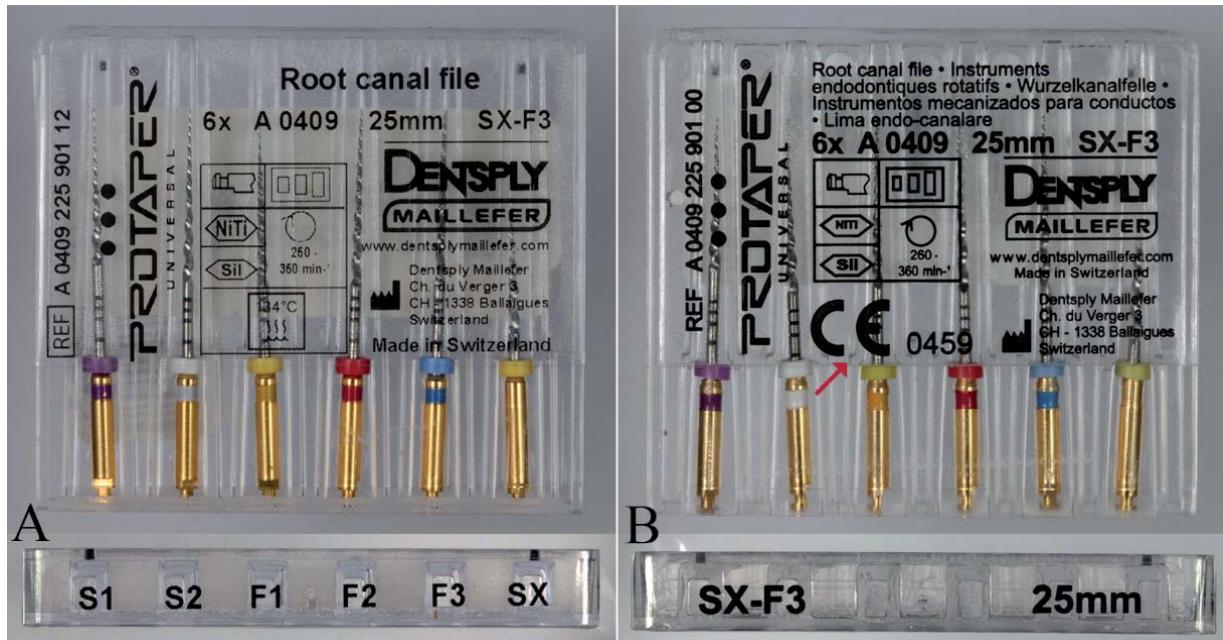


Figura 1. (A) Caja ProTaper Universal. (B) Caja ProTaper Universal adulterada; se pueden observar diferencias en el diseño (flecha).

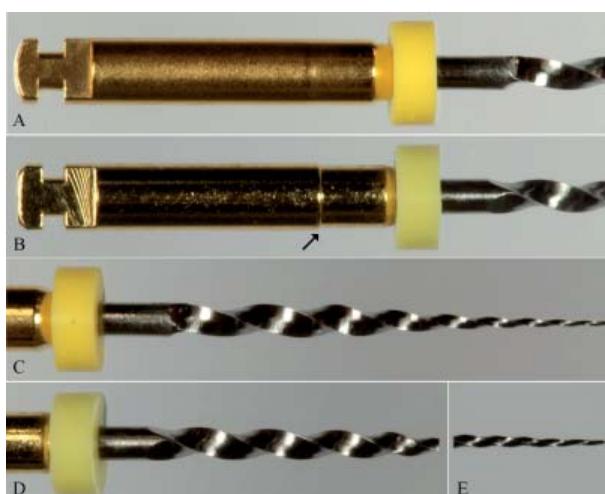


Figura 2. Análisis macroscópico de instrumento SX (A) Vástago original. (B) Vástago adulterado; se pueden observar diferencias en diseño, color y acabado (flecha). (C) Parte activa original. (D) Parte activa adulterada; se pueden observar diferencias en diseño, color y acabado. (E) Punta de instrumento separado.

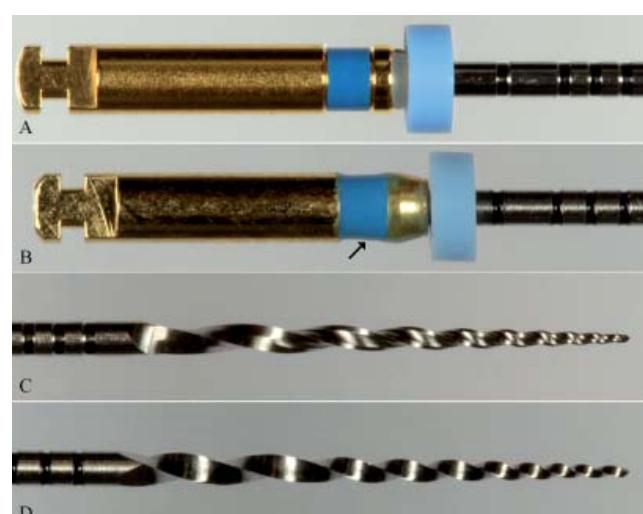


Figura 3. Análisis macroscópico de instrumento F3 (A) Vástago original. (B) Vástago adulterado; se pueden observar diferencias en diseño, color y acabado (flecha). (C) Parte activa original. (D) Parte activa adulterada; se pueden observar diferencias en diseño, color y acabado.

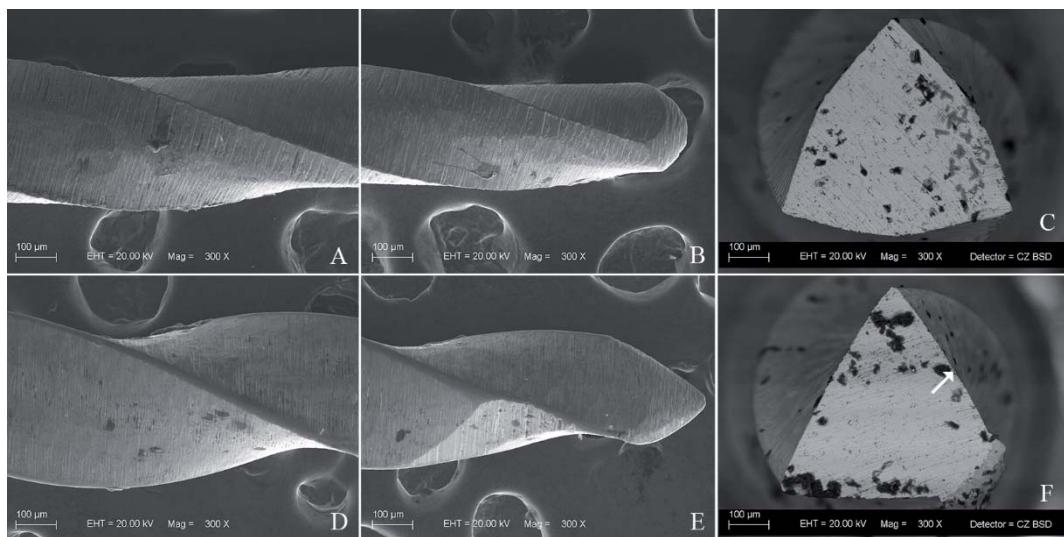


Figura 4. Análisis microscópico de instrumento S1. (A) y (B) Parte activa y punta de instrumento original. (C) Sección transversal de instrumento original. (D) y (E) Parte activa y punta de instrumento adulterado; se pueden observar diferencias en el diseño. (F) Sección transversal de instrumento adulterado, se pueden observar diferencias en el diseño (flecha).

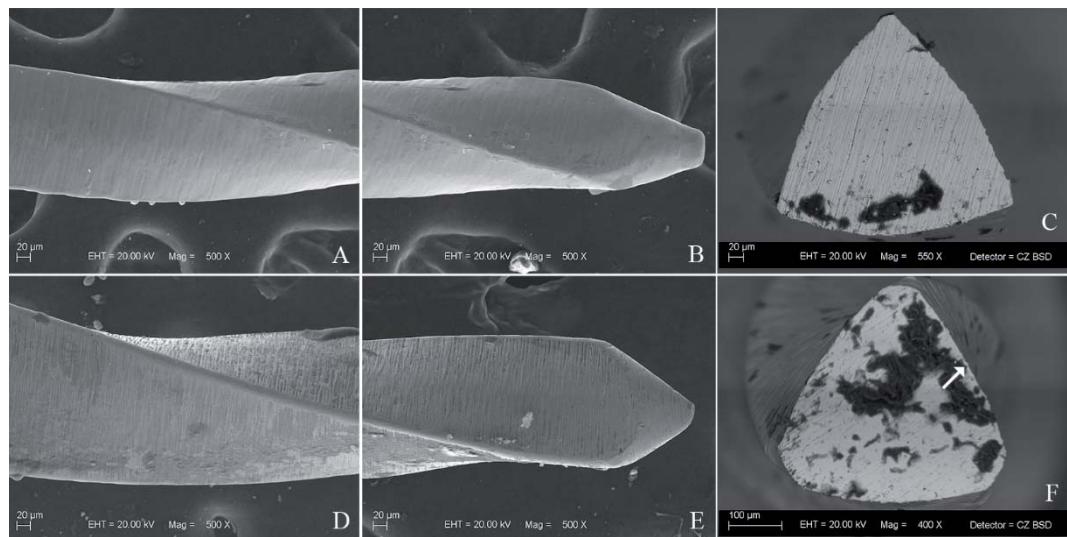


Figura 5. Análisis microscópico de instrumento F1. (A) y (B) Parte activa y punta de instrumento original. (C) Sección transversal de instrumento original. (D) y (E) Parte activa y punta de instrumento adulterada; se pueden observar diferencias en el diseño. (F) Sección transversal de instrumento adulterado, se pueden observar diferencias en el diseño (flecha).

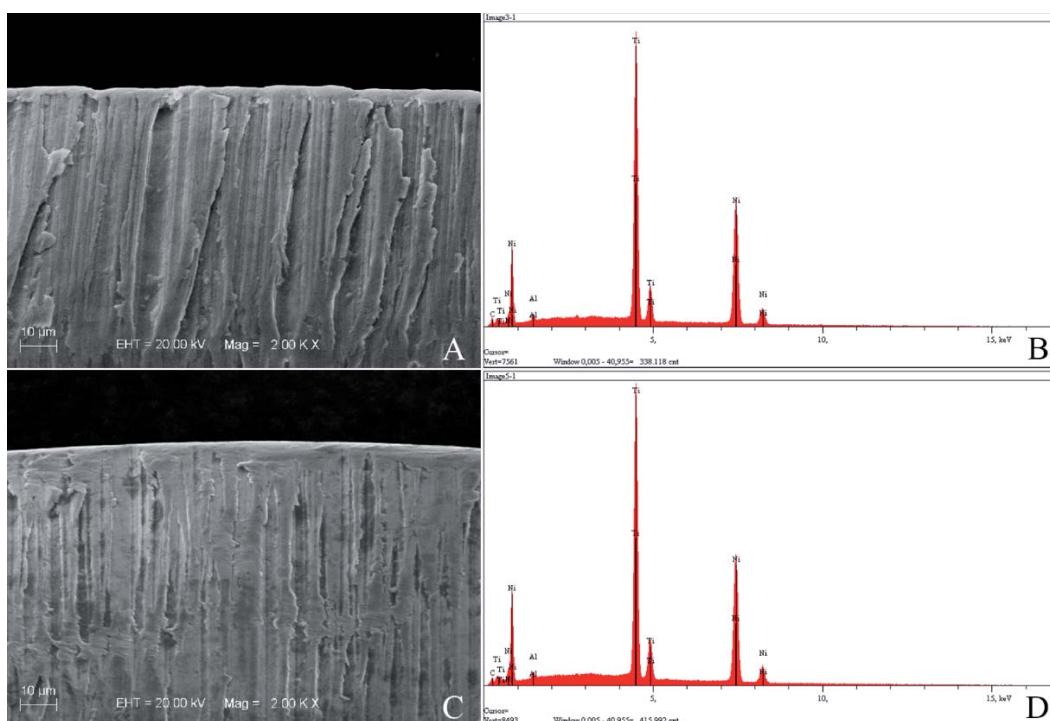


Figura 6. Análisis de composición de instrumento S1. (A) y (B) Instrumento ProTaper Universal original. (C) y (D) Instrumento adulterado. Ambas tienen una composición similar (Ni-Ti).

instrumentos adulterados presentan ángulos de corte romos y ausencia de convexidades triangulares características del sistema (Figura 5 (C y F)), modificando también el formato macroscópico (Figura 3(C)).

Caracterización del material

Al comparar la composición química de los instrumentos originales con sus homólogos adulterados, el análisis EDX mostró que ambos instrumentos tienen una composición Ni-Ti similar (Figura 6), descartando la hipótesis de una composición metálica diferente de los instrumentos adulterados, planteada inicialmente por la separación prematura del instrumento SX adulterado (Figura 2 (E y F)) en su primer uso (el único que se usó clínicamente, antes de identificar que no eran las originales). Podríamos presumir que los instrumentos adulterados fueron fabricados con una aleación Ni-Ti similar al usado en el sistema ProTaper Universal, pero que existen diferencias evidentes en el diseño y fabricación.

DISCUSIÓN

El tratamiento endodóntico está sujeto a diferentes

accidentes y complicaciones, entre ellos, la separación de instrumentos dentro del conducto radicular, desvío o perforación (13,14); sin embargo, nuestra preocupación reside en el aumento de la probabilidad de que estas complicaciones ocurran, no por la falta de habilidad y/o conocimientos del operador, ni por la complejidad anatómica del conducto, sino por una variable adicional inesperada, como podría ser la dudosa procedencia de instrumentos endodónticos, que usan el nombre de marcas conocidas y bastante estudiadas, tanto por clínicos, como por el área de la investigación, ya que su fabricación es de calidad, respaldada por una serie de estudios particulares del fabricante, y reconfirmada por estudios independientes de diversas partes del mundo (12, 18-20).

En este estudio se realizaron tres metodologías diferentes para comparar los instrumentos ProTaper Universal originales con los de dudosa procedencia, análisis macroscópico con fotografía macro, análisis microscópico con microscopía electrónica de barrido y análisis de composición con microanálisis por dispersión de energías de rayos-X (EDX), siendo el análisis macroscópico, en el que se pudieron identifi-

car diferencias resaltantes, que a simple vista podrían pasar por alto, sin embargo con el conocimiento de las características macroscópicas del sistema de limas con el que trabajamos, podríamos estar preparados para no ser sorprendidos.

Este trabajo sirve de base para la realización de estudios de análisis macroscópicos de los diversos sistemas de instrumento endodónticos disponibles en el mercado, para conocimiento de las características singulares de cada uno.

CONCLUSIONES

Las mayores diferencias entre el sistema ProTaper Universal y su homólogo adulterado, se presentaron en el análisis macroscópico, el análisis microscópico presentó diferencias principalmente en el formato de la sección transversal, y la caracterización de materiales de los instrumentos, demostró que eran de composición similar.

Correspondencia:

Gabriela Castro Núñez

Correo electrónico: gabrielamcnunez@foar.unesp.br

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

1. Kim HC, Yum J, Hur B, Cheung GSP. Cyclic Fatigue and fracture characteristics of ground and twisted nickel-titanium rotary files. *J Endod.* 2010; 36(1):147-51.
2. Bonetti Filho I, Esberard RM, Leonardo RT, Del Rio CE. Microscopic evaluation of three endodontic files prepostinstrumentation. *J Endod.* 1998; 24(7):461-4.
3. Alapati SB, Brantley WA, Svec TA, Powers JM, Mitchell JC. Scanning electron microscope observations of new and used nickel-titanium rotary files. *J Endod.* 2004; 29(10):667-9.
4. Vahid A, Roohi N, Zayeri F. A comparative study of four rotary NiTi instruments in preserving canal curvature, preparation time and change of working length. *Aust Endod J.* 2008; 32(5):1-5.
5. Vaudt J, Bitter K, Kielbassa AM. Rotary instruments in vitro. *Endo.* 2007; 1(3):189-293.
6. Foschi F, Nucci C, Montebugnoli L, et al. SEM evaluation of canal wall dentine following use of Mtwo and ProTaper NiTi rotary instruments. *Int Endod J.* 2004; 37:832-9.
7. Bergmans L, Van Cleynenbreugel J, Beullens M, Wevers M, Van Meerbeek B, Lambrechts P. Progressive versus constant tapered shaft design using NiTi rotary instruments. *Int Endod J.* 2003; 36(4):288-95.
8. Montoya JS, Trinidad JG, Loza JAM, Reygadas RC. Estudio comparativo del trabajo biomecánico del sistema Protaper y la instrumentación manual in vitro. *Rev ADM.* 2008; 65(3):126-32.
9. Vieira EP, França EC, Martins RC, Buono VTL, Bahia MGA. Influence of multiple clinical use on fatigue resistance of ProTaper rotary nickel-titanium instruments. *Int Endod J.* 2008; 41:163-72.
10. Sattapan B, Palamara JEA, Messer HH. Torque during canal instrumentation using rotary nickel-titanium files. *J Endod.* 2000 26(3):156-60.
11. Iqbal MK, Kohli MR, Kim JS. A retrospective clinical study of incidence of root canal instrument separation in an endodontics graduate program: a PennEndo database study. *J Endod.* 2006; 32(11):1048-52.
12. Lopes HP, Gambarra-Soares T, Elias CN, et al. Comparison of the mechanical properties of rotary instruments made of conventional nickel-titanium wire, M-ire, or nickel-titanium alloy in R-phase. *J Endod.* 2013; 39: 516-20.
13. Ruddle CJ. The ProTaper technique. *Endod Topics.* 2005;10:187-90.
14. Yared GM, Bou Dagher FE, Machtou P, Kulkarni GK. Influence of rotational speed, torque and operator proficiency on failure of Greater Taper files. *Int Endod J.* 2002;35(1):7-12.
15. West J. Progressive taper technology: rationale and clinical technique for the new ProTaper Universal System. *Dent Today.* 2006; 25:66-9.
16. Simon S, Lumley P, Tomson P, Pertot WJ, Machtou P. Protaper-hybrid technique. *Dent Update.* 2008; 35(2):110-2, 115-6.
17. Lopes HP, Siqueira JR JF. Endodontia: biología e técnica. 4º edição. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015.p. 265-354.
18. Aguiar CM, Mendes DA, Câmara AC, Figueiredo JAP. Evaluation of the centreing ability of the ProTaper Universal™ rotary system in curved roots in comparison to Nitiflex™ files. *Aust Endod J.* 2009; 35: 174-9.
19. Kunert GG, Fontanella VRC, de Moura AAM, Barletta FB. Analysis of apical root transportation associated with ProTaper Universal F3 and F4 instruments by using digital subtraction radiography. *J Endod.* 2010; 36: 1052-5.
20. Aguiar CM, Mendes DA, Câmara AC, Figueiredo JAP. Assessment of canals walls after biomechanical preparation of root canals instrumented with ProTaper Universal™ rotary system. *J Appl Oral Sci.* 2009; 17: 590-5. Taper Universal adulterada; se pueden observar diferencias en el diseño (flecha).seño, color y acabado.

Recibido : 30/12/2015

Aceptado: 21/10/2016