

Ingeniería. Revista de la Universidad de

Costa Rica

ISSN: 1409-2441

marcela.quiros@ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Gómez Valverde, Juan; Sánchez Vargas, Harold

## RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS DE CALIBRACIÓN DE MULTÍMETROS CAMET 2009

Ingeniería. Revista de la Universidad de Costa Rica, vol. 19, núm. 2, agosto-diciembre,  
2009, pp. 73-90

Universidad de Costa Rica

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44170523006>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

# RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS DE CALIBRACIÓN DE MULTÍMETROS CAMET 2009

Juan Gómez Valverde  
Harold Sánchez Vargas

## Resumen

Se presentan los resultados de la segunda comparación en calibración de multímetros, organizada en Costa Rica, por el Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas (LMVE) en la que participaron doce laboratorios, con capacidad para calibrar multímetros digitales. El LMVE es un laboratorio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que ha sido designado como laboratorio nacional en electricidad, magnetismo, tiempo y frecuencia por el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET).

La comparación siguió los lineamientos de la *INTE ISO/IEC Guía 43-1:2000 Ensayo de aptitud por comparaciones interlaboratorios. Parte 1: Desarrollo y funcionamiento de programas de ensayos de aptitud* (INTECO, 2000) y se analizaron tres mensurados, a saber: corriente, voltaje y resistencia.

Se tuvo participación de laboratorios nacionales y el laboratorio nacional de Panamá, evidenciando la importancia de este tipo de ejercicios, los cuales pueden ampliarse, por ejemplo, hacia la región Centroamericana.

Entre los principales resultados están el buen uso que puedan hacer los laboratorios participantes para implantar acciones de mejora en su gestión metrológica, así como el aumento en el conocimiento a nivel nacional de la capacidad de medición en estas magnitudes, de voltaje, corriente, resistencia entre otros.

**Palabras clave:** multímetro, calibración, comparación, interlaboratorios, metrología.

## Abstract

Results are presented for the second multimeter calibration intercomparison organized in Costa Rica by Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas (LMVE), with participation of twelve laboratories with capability for calibration of multimeters. LMVE belongs to Instituto Costarricense de Electricidad and is designated by Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) as national laboratory in electricity, magnetism, time and frequency.

The comparison followed guidance in (Costa Rican version of) *ISO/IEC Guide 43-1 Proficiency testing by interlaboratory comparisons -- Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes*, analyzing three measurands: current, voltage and resistance.

There was participation of Costa Rican laboratories and the Panama national laboratory, showing the importance of these exercises, which can be expanded to the Central American region.

Among the main results are the use by participant laboratories for improvement action in their metrology activities, and better national knowledge in measuring voltage, current and resistance.

**Keywords:** multimeter, calibration, comparison, interlaboratory, metrology.

**Recibido:** 09 de febrero del 2010 • **Aprobado:** 11 de febrero del 2010.

## 1. INTRODUCCIÓN

El Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas (LMVE) del ICE, como laboratorio designado por LACOMET en Electricidad e Infocomunicaciones, de acuerdo con el convenio

firmado por LACOMET y el ICE en setiembre de 2004, organizó una comparación de calibración de multímetros.

La norma *INTE-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración* (INTECO, 2005) incluye:

**“5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración”**

*El laboratorio debe tener procedimientos de control de calidad para dar seguimiento a la validez de los ensayos y las calibraciones que realiza. Los datos resultantes deben ser registrados de tal manera que se puedan detectar tendencias y, cuando sea factible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento debe ser planificado y revisado y puede incluir, pero no estar limitado a, lo siguiente:*

- a) uso regular de materiales de referencia certificados y/o controles de calidad internos utilizando materiales de referencia secundarios;
- b) participación en programas de comparaciones interlaboratorios o ensayos de aptitud;
- c) repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo o diferentes métodos;
- d) reensayo o recalibración de los objetos retenidos;
- e) correlación de resultados para diferentes características del objeto.”

La política “ECA-MC-P17 Política y criterios para la participación en ensayos/ pruebas de aptitud y otras comparaciones para los laboratorios” incluye, entre algunas formas de aseguramiento de la calidad:

**“7. REQUISITOS GENERALES”**

*Los criterios del ECA para la Acreditación de laboratorios establecen los siguientes requisitos en relación a la participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones:*

**7.1. Demostración de la competencia técnica de los laboratorios para la realización de los ensayos o calibraciones acreditados o en proceso, por medio de la participación en programas de ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones para los laboratorios de ensayo y de calibración, donde tales actividades estuvieren disponibles.**

**7.2. Una cantidad mínima de ensayos/ pruebas de aptitud y otras comparaciones adecuadas para los laboratorios es:**

**7.2.1. Una participación antes de la Acreditación,**

**7.2.2. Para el caso de los laboratorios de ensayo deberán participar como mínimo una vez cada cuatro años en ensayos/ pruebas de aptitud u otras comparaciones relacionadas con cada disciplina principal correspondiente al alcance de la Acreditación, ejemplos de disciplinas se dan en la nota 3.**

**Nota 3: Ejemplos de disciplinas:**

- Análisis ambiental: suelo (incluyendo desechos sólidos, lodo, compost, foliares);
- Análisis ambiental: aguas (aguas residuales, aguas subterráneas, agua potable);
- Análisis ambiental: aire (emisiones e inmisiones);
- Pruebas de materiales: parámetros químicos
- Pruebas de materiales: cantidades físicas
- Pruebas de materiales: pruebas no destructivas

**7.2.3. Para el caso de los laboratorios de calibración deberán participar como mínimo una vez cada cuatro años en pruebas de aptitud u otras comparaciones para cada magnitud a calibrar o medir (ejemplo: voltaje, masa, temperatura etc.); correspondientes al alcance de la Acreditación del laboratorio”.**

Esta comparación siguió los lineamientos de la INTE ISO/IEC Guía 43-1:2000. “Ensayo de aptitud por comparaciones interlaboratorios. Parte 1: Desarrollo y funcionamiento de programas de ensayos de aptitud”.

*“El seguimiento debe ser planificado y revisado, y puede incluir los siguientes elementos:*

- *materiales de referencia secundarios;*
- *la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud;*
- *la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos diferentes;*
- *la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos;*
- *la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem.”*

Para una mejor comprensión se incluyen las siguientes definiciones. También se puede consultar el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología).

- A CA: Amperios corriente alterna.
- A CD: Amperios corriente directa.
- CAMET: subregión metrológica centroamericana, del Sistema Interamericano de Metrología.
- Comparación interlaboratorio: organización, realización y evaluación de ensayos o calibraciones sobre el mismo objeto de ensayo o sobre objetos de ensayos similares, por dos o más laboratorios, de acuerdo con condiciones predeterminadas.
- ECA: Ente Costarricense de Acreditación.
- ICE: Instituto Costarricense de Electricidad.
- Incertidumbre estándar: incertidumbre del resultado de una medición expresada como una desviación estándar.
- Incertidumbre estándar combinada: incertidumbre estándar del resultado de una medición cuando el resultado se obtiene a partir de los valores de algunas otras magnitudes, igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de términos, siendo estos términos las varianzas y covarianzas de estas otras magnitudes ponderadas de acuerdo a cómo el resultado de la medición varía con respecto a cambios en estas magnitudes.
- Incertidumbre expandida: cantidad que define un intervalo alrededor de una medición del que se puede esperar que abarque una fracción grande de la distribución de valores que razonablemente pudieran ser atribuidos al mensurando.

- INTECO: Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica.
- LACOMET: Laboratorio Costarricense de Metrología.
- LMVE: Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas.
- Medición de periodo: medición del intervalo de tiempo entre dos sucesos, el primer suceso marcará el instante del comienzo (arranque) del intervalo de tiempo, marcando el segundo suceso el instante de finalización (parada) de la cuenta.
- Método de estrella: Es cuando el instrumento o material de referencia utilizado en la comparación es devuelto al laboratorio de referencia cada vez que el participante finaliza la medición.
- $\Omega$ : ohm.
- Patrón viajero: Patrón, algunas veces de construcción especial, para ser transportado entre diferentes lugares.
- V CA: Voltaje corriente alterna.
- V CD: Voltaje corriente directa.

## 2. METODOLOGÍA

La comparación de calibración en multímetros se realizó con el fin de estimar los niveles de concordancia en la calibración de voltaje, corriente y resistencia entre los laboratorios participantes, incluyendo la desviación y la incertidumbre de medición asociada. El requisito para participar fue tener la capacidad para calibrar multímetros digitales.

Las fechas de participación fueron desde el 24 de abril del 2009 hasta el 17 de setiembre del 2009. Los laboratorios participantes fueron doce, el laboratorio piloto y once más, codificados con los números del 1 al 12, en orden aleatorio.

Laboratorio piloto:

Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas (ICE-LMVE)  
Instituto Costarricense de Electricidad  
Correo electrónico: lmve@ice.go.cr

**Cuadro 1.** Valores para la calibraciones del multímetro.

Punto	Unidades	Escala	Valor nominal	Frecuencia
1	mV	300	100	
2	V	3	1	
3	V	30	10	
4	mA	300	100	
5	mA	1000	1000	
6	V	300	100	@ 60 Hz
7	V	300	120	@ 60 Hz
8	mA	1000	500	@ 1 kHz
9	mA	300	10	@ 5 kHz
10	mA	300	100	@ 5 kHz
11	mA	1000	1000	@ 5 kHz
12	mA	1000	1000	@ 60 Hz
13	kΩ	3	1	
14	kΩ	30	10	
15	kΩ	300	100	
16	kΩ	3000	1000	

Fuente: (LMVE, 2009).

#### Laboratorios participantes:

- Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas (LMVE), Instituto Costarricense de Electricidad.
- Laboratorio de Metrología de DT DEP (LAMETRO), Instituto Costarricense de Electricidad.
- Metcal Engineering Services.
- SCM Metrología y Laboratorios S. A.
- Laboratorio de Calibración de Equipos de Medición de Bridgestone de Costa Rica.
- Calibraciones de América CAMÉRICA S.A.
- UEN CENCE, Instituto Costarricense de Electricidad.
- LMVE-DTOM, Instituto Costarricense de Electricidad.
- DIM Metrología.
- Centro Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP)
- A Uno Calibration Laboratory S.A.

- LMVE-CSTRC, Instituto Costarricense de Electricidad.

Se utilizó como patrón viajero un multímetro marca Hioki, modelo 3235, propiedad del ICE. Fue responsabilidad de cada participante el transporte desde y hacia el LMVE del patrón viajero. Cada participante entregó al LMVE el formulario de recepción y de compromiso de devolución en la fecha acordada. Cada participante debía informar al LMVE con un día de anticipación sobre la fecha de devolución al LMVE. El patrón viajero fue transportado en una caja protectora. Cada participante usó sus procedimientos para estas actividades.

Estaba previsto que en caso de falla el participante debía informar lo antes posible al LMVE para coordinar las mejores actividades a realizar; afortunadamente, no hubo fallas del patrón durante la actividad. Cada participante cubrió el costo del transporte del patrón viajero

desde y hacia el LMVE. Fue recomendada una póliza temporal de seguro o cualquier cobertura que el participante pudiera disponer.

Se usó el método de estrella para la circulación del patrón, estando una semana en el sitio de cada participante y una semana en el LMVE, donde se realizaron mediciones previas de caracterización y se realizaron mediciones intercaladas entre cada participante.

Los valores correspondientes a V CD, V CA, A CD, A CA,  $\Omega$ , fueron escogidos de una lista de sesenta y seis posibles.

## 2.1. Incertidumbre de la medición

Los participantes reportaron sus resultados con la incertidumbre asociada, con un factor de cobertura de dos sigma (95,45 %), considerando como mínimo las incertidumbres debidas a la especificación del patrón del participante, resolución del patrón viajero y la variabilidad de las mediciones repetidas.

## 2.2. Reporte de mediciones

Para el reporte de las mediciones, cada participante, usando sus propios formatos, envió al LMVE sus resultados de medición.

Nota: Cada participante reportó sus resultados de acuerdo con sus procedimientos, sin que le correspondiera al laboratorio piloto la evaluación de su calidad técnica.

## 2.3. Valor de referencia

El valor de referencia de la comparación fue definido por el LMVE como el promedio de las mediciones realizadas en el patrón viajero antes y después de las mediciones de cada participante, usando un calibrador multifunción Fluke 5720A, con trazabilidad al SI mediante los certificados de calibración ICE-LMVE-I-2077-31jul2008 y ICE-LMVE-I-2077-02set2009. El patrón viajero mantuvo estabilidad en sus mediciones, dentro de sus especificaciones, durante toda la comparación.

## 3. RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN

En las Figuras de la 1 a la 16 se grafican los límites superior e inferior de incertidumbre del LMVE al 95,45 % de confianza, en sus respectivas unidades. El valor medido reportado por el LMVE es la línea continua que se encuentra entre las líneas discontinuas. Los datos fueron graficados con la cantidad de dígitos reportados por cada participante, lo cual muestra una variación referente al informe expuesto en los Cuadros 2 y 3. Los datos fueron truncados a la cantidad de dígitos correspondientes a la resolución del instrumento.

Cada punto representa el valor reportado por cada participante en cada medición, con su respectiva incertidumbre. La información brindada en los cuadros y en las figuras es suficiente para que cada participante realice su cálculo de error normalizado, de acuerdo con las referencias INTECO y ECA. De estos datos se puede ver el error que tiene cada participante en su sistema de calibración y su incertidumbre total. Esta información es útil para que los usuarios de servicios de calibración puedan ver el desempeño de sus proveedores, para que los organismos que proveen acreditación evalúen a sus acreditados y para que los propios laboratorios analicen y mejoren sus procesos de calibración. Los resultados de esta comparación interlaboratorio son de utilidad para que cada laboratorio respalde sus capacidades de medición y calibración, de acuerdo con la norma de competencia técnica de laboratorios y la guía para ensayos de aptitud por comparación interlaboratorios.

Nota: Los participantes cuatro y once no aparecen en los Cuadros ni en las figuras, debido a que uno de ellos no entregó resultados y el otro solicitó que sus datos no fueran publicados. Los participantes dos y siete no reportaron algunos valores de corriente, como se muestra en los Cuadros 3 y 4.

En esta comparación participó, además de los laboratorios costarricenses, el laboratorio nacional de Panamá, CENAMEP. Se espera que esta iniciativa se continúe extendiendo con la participación de otros laboratorios de CAMET, para el beneficio del movimiento de servicios y productos y la mejora en la calidad de vida de los habitantes, por medio de mejora en la capacidad metrológica de nuestros países.

### 3.1. Datos de mediciones

Cuadro 2. Valores numéricos obtenidos por los participantes en la comparación.

Punto	Función	Escala	Valor nominal	Frecuencia	Unidades	LMVE		Participante (1)
						Medido	Incertidumbre	
						Unidades	Unidades	
1	Voltaje	300 mV	100 mV		100,00	0,0059	100,00	0,0062
2	Corriente Directa	3 V	1 V		1,0001	0,000058	1,0000	0,000059
3		30 V	10 V		10,000	0,00058	10,00	0,00058
4	Corriente Directa	300 mA	100 mA		100,15	0,0084	100,14	0,0068
5		1000 mA	1000 mA		1000,5	0,12	1000,4	0,058
6	Voltaje Corriente Alterna	300 V	100 V	@ 60 Hz	99,88	0,0088	99,89	0,0091
7		300 V	120 V	@ 60 Hz	119,89	0,0095	119,91	0,0091
8	1000 mA	500 mA		@ 1 kHz	498,3	0,18	498,4	0,060
9	300 mA	10 mA		@ 5 kHz	9,796	0,0070	9,800	0,0060
10	Corriente Alterna	300 mA	100 mA	@ 5 kHz	99,93	0,025	99,94	0,016
11	1000 mA	1000 mA		@ 5 kHz	998,4	0,55	998,6	0,060
12	1000 mA	1000 mA		@ 60 Hz	999,1	0,31	999,4	0,060
13	3 kΩ	1 kΩ			0,9998	0,000065	0,9999	0,000058
14	30 kΩ	10 kΩ			9,999	0,00061	9,998	0,00058
15	Resistencia	300 kΩ	100 kΩ		99,97	0,0060	99,97	0,0059
16		3000 kΩ	1000 kΩ		999,7	0,068	999,7	0,058

Fuente: (LMVE, 2009).

**Cuadro 3.** Valores numéricos obtenidos por los participantes en la comparación.

Punto	Función	Escala	Valor nominal	Frecuencia	Unidades	Participante (2)		Participante (3)		Participante (5)	
						Medido	Incertidumbre	Medido	Incertidumbre	Medido	Incertidumbre
1	Voltaje	300 mV	100 mV		100,00	0,0065	100,00	0,0058	100,00	0,0098	
2	Corriente Directa	3 V	1 V		1,0001	0,000067	1,0001	0,000068	1,0000	0,000098	
3		30 V	10 V		10,00	0,00059	10,00	0,00068	10,00	0,0010	
4	Corriente Directa	300 mA	100 mA		100,13	0,013	100,15	0,0058	100,15	0,021	
5		1000 mA	1000 mA		1000,5	0,24	1000,5	0,063	1000,0	0,56	
6	Voltaje	300 V	100 V	@ 60 Hz	99,88	0,020	99,87	0,011	99,88	0,037	
7	Corriente Alterna	300 V	120 V	@ 60 Hz	119,90	0,024	119,87	0,014	119,89	0,062	
8		1000 mA	500 mA	@ 1 kHz	498,4	4,0	498,4	0,058	498,1	0,76	
9		300 mA	10 mA	@ 5 kHz	---	---	9,800	0,0069	9,790	0,014	
10	Corriente Alterna	300 mA	100 mA	@ 5 kHz	---	---	99,92	0,0058	99,94	0,11	
11		1000 mA	1000 mA	@ 5 kHz	---	---	998,80	0,10	997,6	3,9	
12		1000 mA	1000 mA	@ 60 Hz	999,2	0,54	999,1	0,10	998,6	1,2	
13		3 kΩ	1 kΩ		0,9997	0,00024	0,9998	0,000068	0,9997	0,00019	
14		30 kΩ	10 kΩ		9,998	0,0015	9,999	0,00068	9,999	0,0023	
15		300 kΩ	100 kΩ		99,97	0,010	99,98	0,0059	99,98	0,022	
16		3000 kΩ	1000 kΩ		999,7	0,10	999,7	0,070	999,5	0,47	

Fuente: (LMVE, 2009).

**Cuadro 4.** Valores numéricos obtenidos por los participantes en la comparación.

Punto	Función	Escala	Valor nominal	Frecuencia	Unidades	LMVE			Participante (6)			Participante (7)		
						Medido	Unidades	Incertidumbre	Medido	Unidades	Incertidumbre	Medido	Unidades	Incertidumbre
1	Voltaje	300 mV	100 mV		100,00	0,0059		100,00	0,013		100,00	0,012		
2	Corriente Directa	3 V	1 V		1,0001	0,000058		1,0001	0,00013		1,0001	0,00011		
3		30 V	10 V		10,000	0,00058		10,00	0,0014		10,00	0,0011		
4	Corriente Directa	300 mA	100 mA		100,15	0,0084		100,14	0,030		100,15	0,060		
5		1000 mA	1000 mA		1000,5	0,12		1000,7	0,83		1000,7	0,60		
6	Voltaje Corriente Alterna	300 V	100 V	@ 60 Hz	99,88	0,0088		99,88	0,054		99,88	0,080		
7		300 V	120 V	@ 60 Hz	119,89	0,0095		119,88	0,092		119,90	0,089		
8		1000 mA	500 mA	@ 1 kHz	498,3	0,18		498,4	1,1		498,4	1,3		
9		300 mA	10 mA	@ 5 kHz	9,796	0,0070		9,800	0,020		---	---		
10	Corriente Alterna	300 mA	100 mA	@ 5 kHz	99,93	0,025		99,99	0,17		---	---		
11		1000 mA	1000 mA	@ 5 kHz	998,4	0,55		998,5	0,98		---	---		
12		1000 mA	1000 mA	@ 60 Hz	999,1	0,31		999,1	1,7		999,1	2,2		
13		3 kΩ	1 kΩ		0,9998	0,000065		0,9998	0,00027		0,9997	0,00013		
14		30 kΩ	10 kΩ		9,999	0,00061		10,000	0,0027		9,998	0,0013		
15		300 kΩ	100 kΩ		99,97	0,0060		99,98	0,031		99,97	0,013		
16		3000 kΩ	1000 kΩ		999,7	0,068		999,8	0,36		999,6	0,26		


Fuente: (LMVE, 2009).

**Cuadro 5.** Valores numéricos obtenidos por los participantes en la comparación.

Punto	Función	Escala	Valor nominal	Frecuencia	Participante (8)			Participante (9)			Participante (10)		
					Medido	Incertidumbre	Unidades	Medido	Incertidumbre	Unidades	Medido	Incertidumbre	Unidades
1	Voltaje	300 mV	100 mV		100,00	0,012	100,00	0,0059	99,998	0,0086			
2	Corriente Directa	3 V	1 V		1,0001	0,00011	0,9999	0,00010	1,0001	0,0085			
3		30 V	10 V		10,00	0,0011	10,00	0,00060	10,00	0,058			
4	Corriente Directa	300 mA	100 mA		100,14	0,020	100,15	0,023	100,01	0,059			
5		1000 mA	1000 mA		1000,5	0,15	1000,1	0,21	1000,2	0,077			
6	Voltaje	300 V	100 V	@ 60 Hz	99,88	0,021	99,87	0,018	99,87	0,10			
7	Corriente Alterna	300 V	120 V	@ 60 Hz	119,89	0,040	119,89	0,021	120,00	0,067			
8		1000 mA	500 mA	@ 1 kHz	498,0	0,55	498,2	0,28	498,3	0,15			
9		300 mA	10 mA	@ 5 kHz	9,790	0,021	9,790	0,0060	9,814	0,059			
10	Corriente Alterna	300 mA	100 mA	@ 5 kHz	99,92	0,23	99,94	0,040	100,00	0,094			
11		1000 mA	1000 mA	@ 5 kHz	997,28	0,93	998,6	5,4	998,8	0,036			
12		1000 mA	1000 mA	@ 60 Hz	998,9	0,82	998,6	0,47	999,1	0,43			
13		3 kΩ	1 kΩ		0,9999	0,00011	0,9997	0,00010	1,0004	0,00012			
14	Resistencia	30 kΩ	10 kΩ		9,999	0,0011	9,998	0,00060	9,994	0,00059			
15		300 kΩ	100 kΩ		99,97	0,012	99,96	0,0062	99,97	0,00016			
16		3000 kΩ	1000 kΩ		999,6	0,12	999,6	0,12	999,4	0,12			


Fuente: (LMVE, 2009).

### 3.2 Resultados de la intercomparación

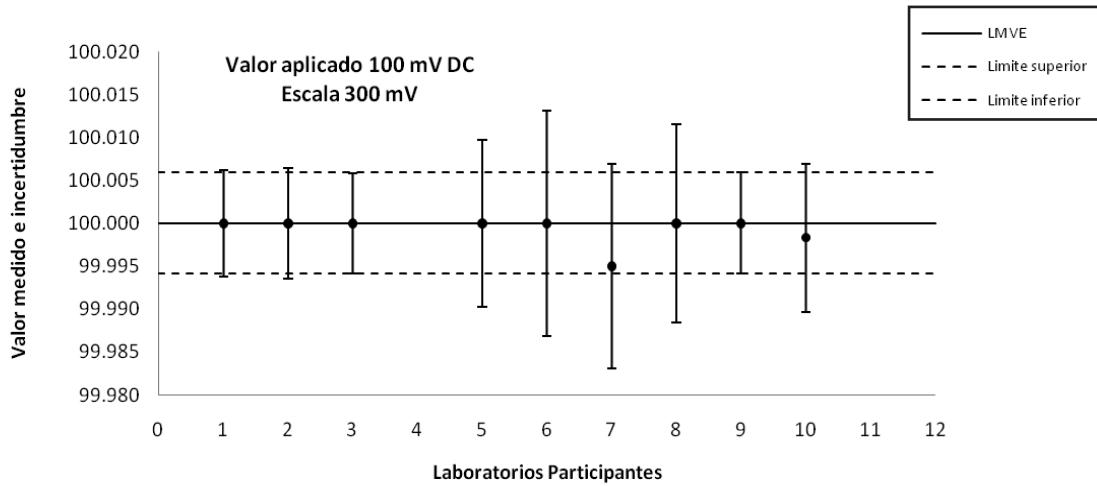

**Figura 1.** Gráfico de resultados de la comparación en 100 mV.


Fuente: (LMVE, 2009)

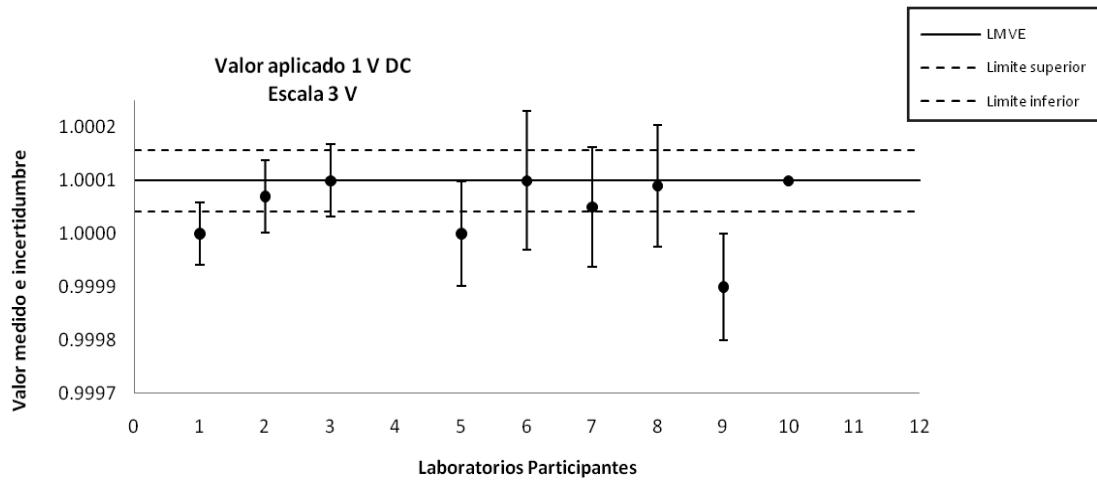


Nota: La incertidumbre reportada por el participante (10) no se incluye en el gráfico porque excede la coordenada vertical

**Figura 2.** Gráfico de resultados de la comparación en 1 V.


Fuente: (LMVE, 2009).

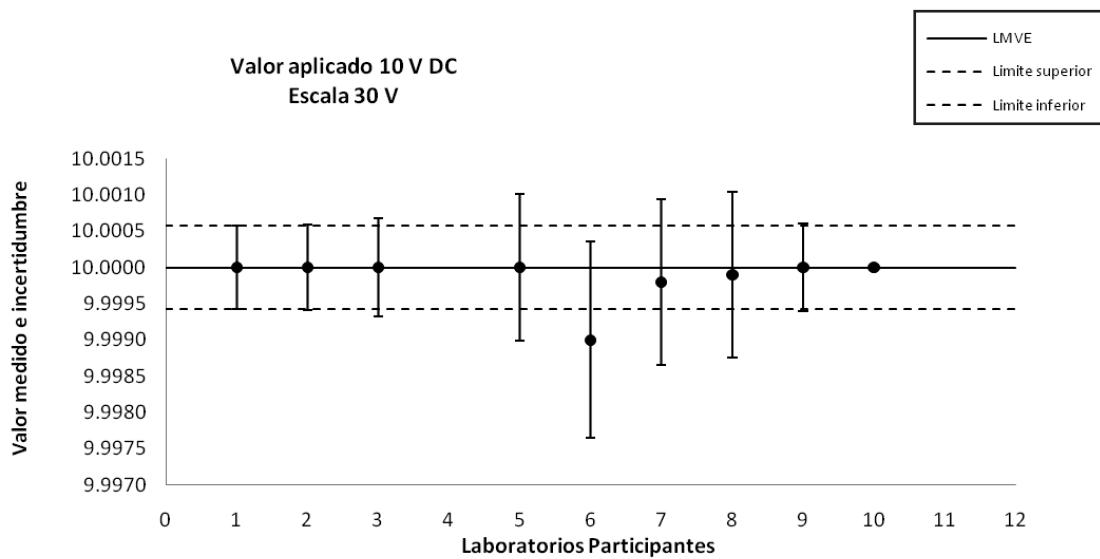**Figura 3.** Gráfico de resultados de la comparación en 10 V.


Fuente: (LMVE, 2009).

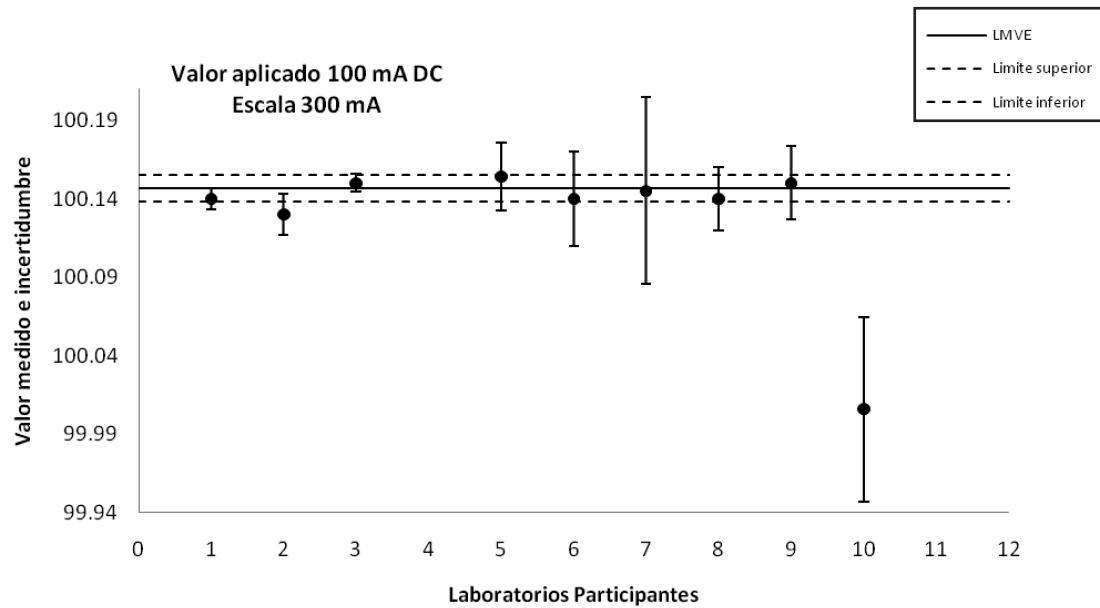**Figura 4.** Gráfico de resultados de la comparación en 100 mA DC.


Fuente: (LMVE, 2009).

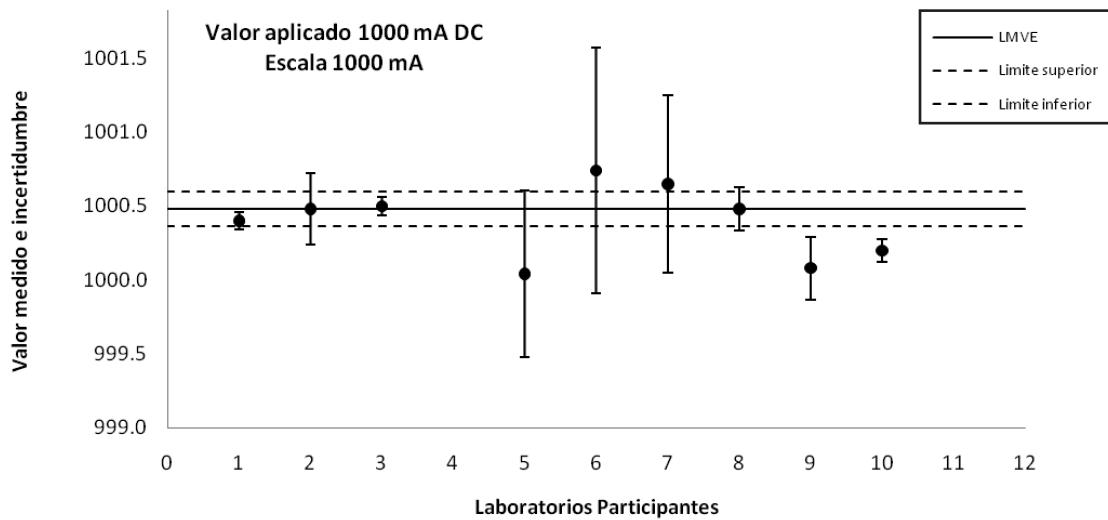**Figura 5.** Gráfico de resultados de la comparación en 1000 mA DC.


Fuente: (LMVE, 2009).

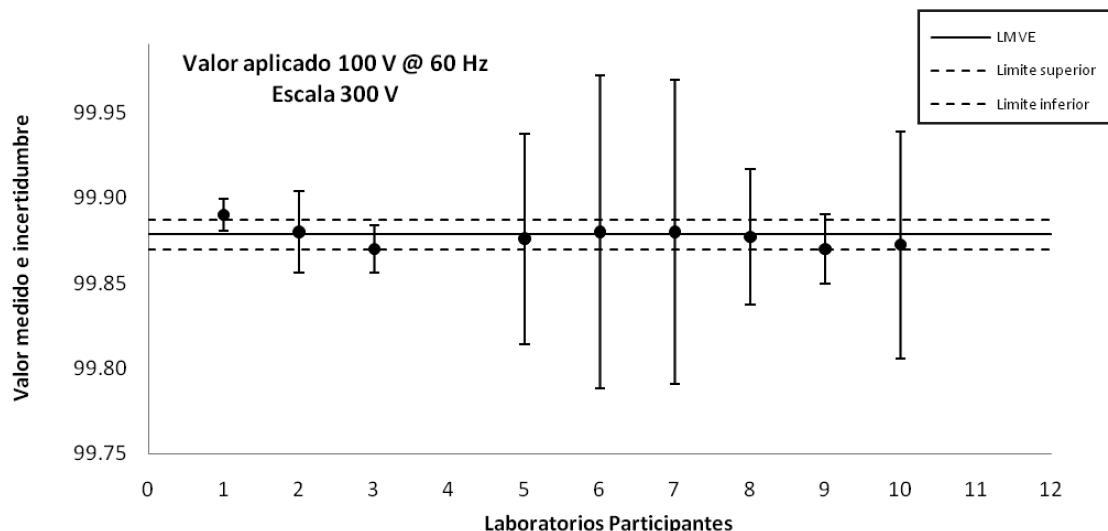**Figura 6.** Gráfico de resultados de la comparación en 100 VCA @ 60 Hz.

Fuente: (LMVE, 2009).

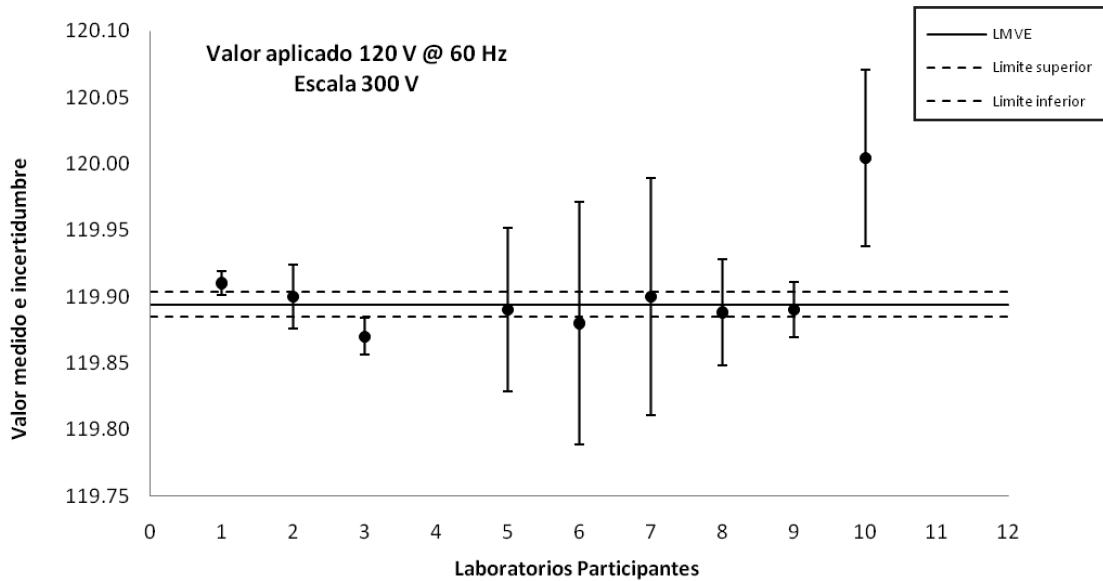**Figura 7.** Gráfico de resultados de la comparación en 120 VCA @ 60 Hz.


Fuente: (LMVE, 2009).

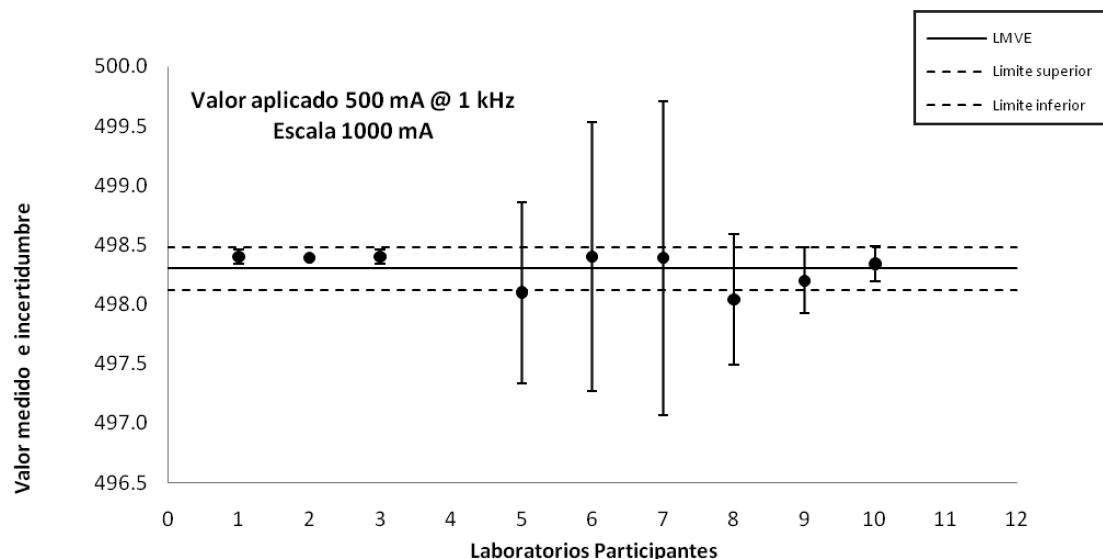

Nota: La incertidumbre reportada por el participante (2) no se incluye en el gráfico porque excede la coordenada vertical.

**Figura 8.** Gráfico de resultados de la comparación en 500 mA CA @ 1 kHz.


Fuente: (LMVE, 2009).

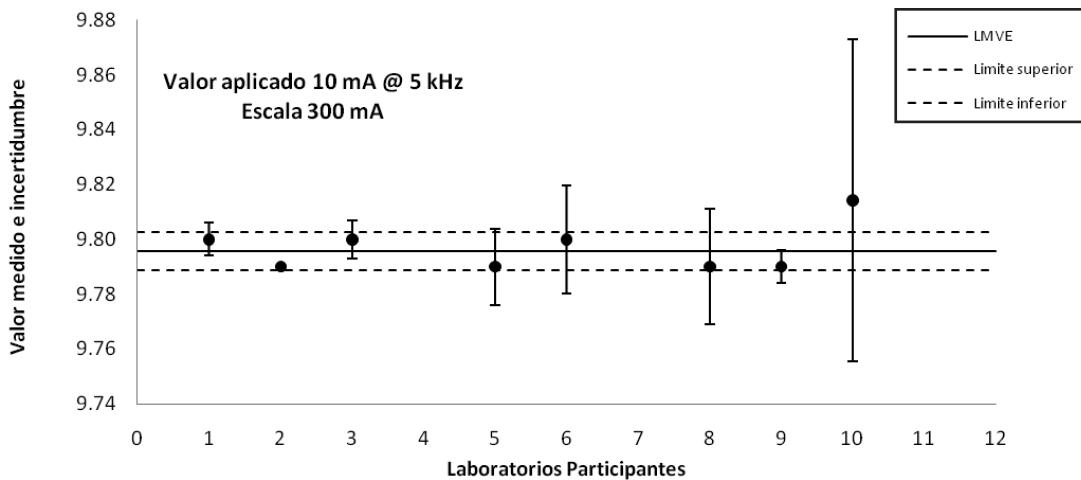

Nota: La incertidumbre reportada por el participante (2) no se incluye en el gráfico porque excede la coordenada vertical.

**Figura 9.** Gráfico de resultados de la comparación en 10 mA CA @ 1 kHz.


Fuente: (LMVE, 2009).

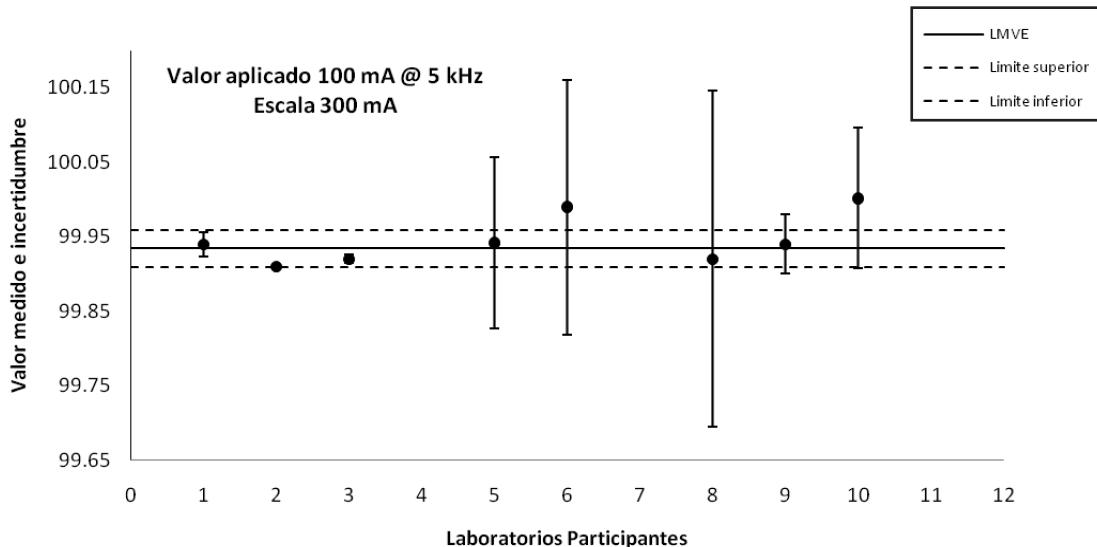

Nota: La incertidumbre reportada por el participante (2) no se incluye en el gráfico porque excede la coordenada vertical.

**Figura 10.** Gráfico de resultados de la comparación en 100 mA CA @ 1 kHz.

Fuente: (LMVE, 2009).

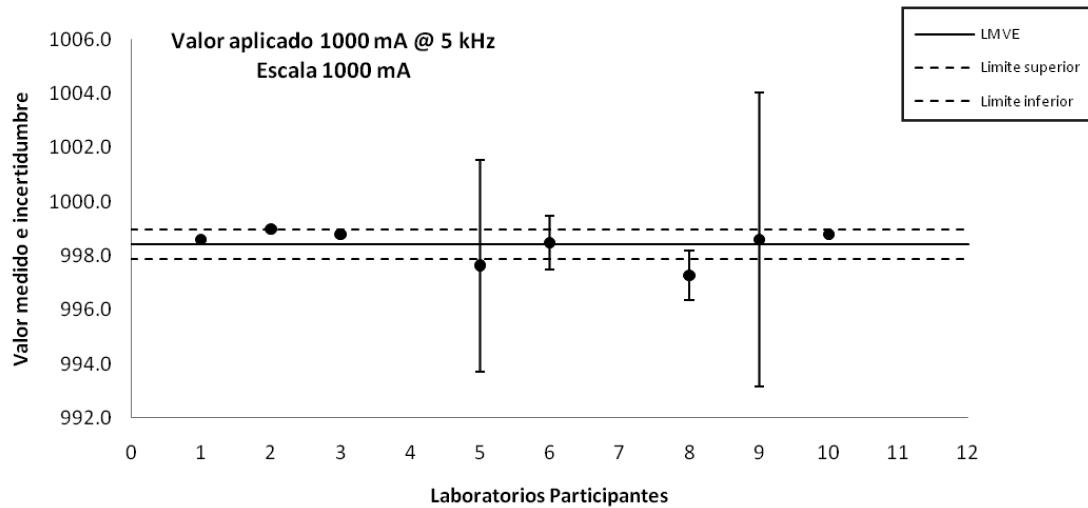


Nota 1: La incertidumbre reportada por el participante (2) no se incluye en el gráfico porque excede la coordenada vertical.

Nota 2: Las incertidumbres de los participantes (1, 3 y 10) están incluidas pero su aporte es insignificante y no es posible apreciarlas bien en el gráfico.


**Figura 11.** Gráfico de resultados de la comparación en 1000 mA CA @ 1 kHz.

Fuente: (LMVE, 2009).

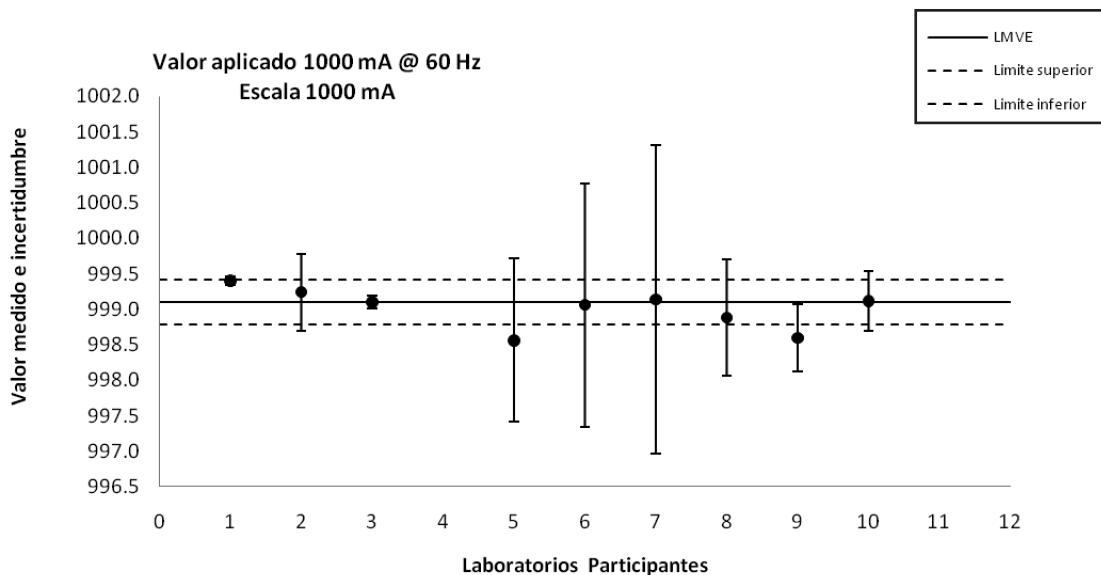


**Figura 12.** Gráfico de resultados de la comparación en 1000 mA CA @ 60 Hz.


Fuente: (LMVE, 2009).

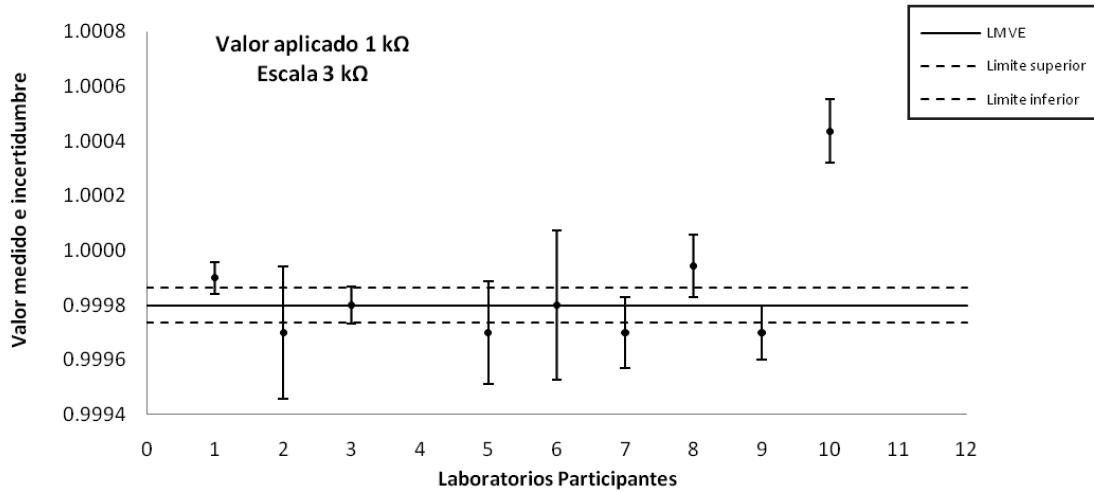**Figura 13.** Gráfico de resultados de la comparación en 1 kΩ.

Fuente: (LMVE, 2009).

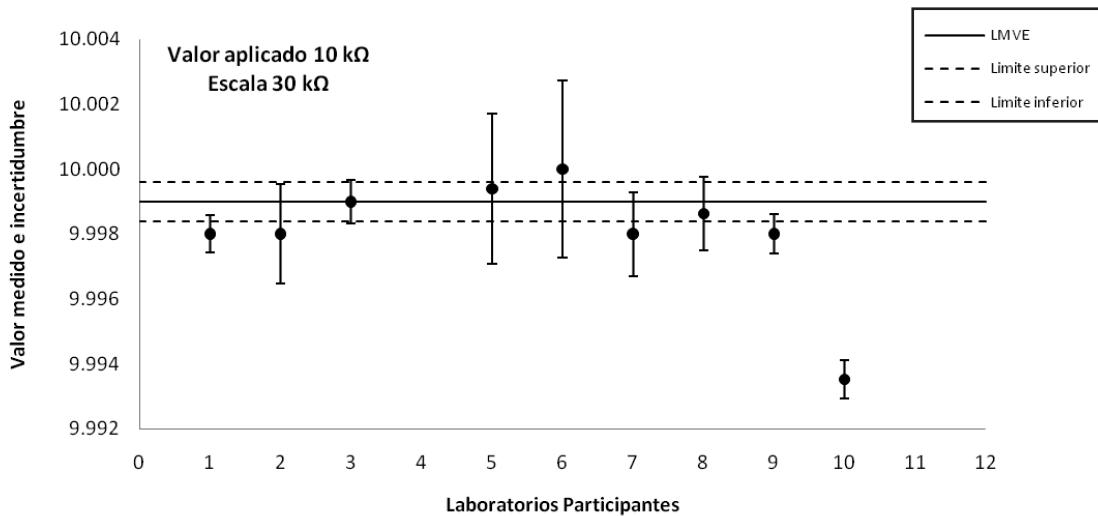**Figura 14.** Gráfico de resultados de la comparación en 10 kΩ.


Fuente: (LMVE, 2009).

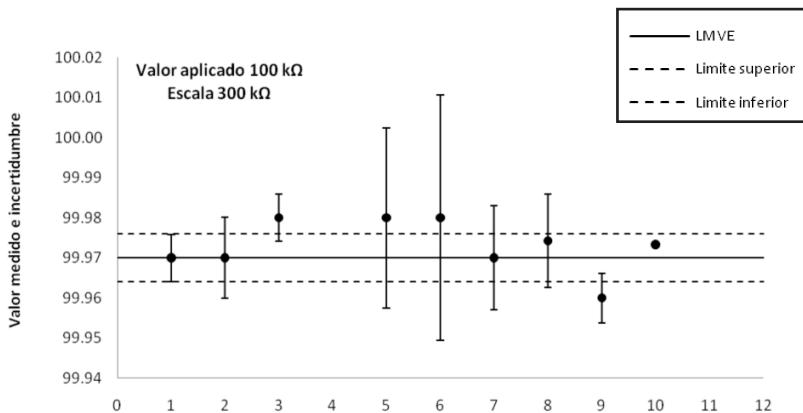

Nota: La incertidumbre del participante (10) está incluida pero su aporte es insignificante y no es posible apreciarla bien en el gráfico.

**Figura 15.** Gráfico de resultados de la comparación en 100 kΩ.

Fuente: (LMVE, 2009).

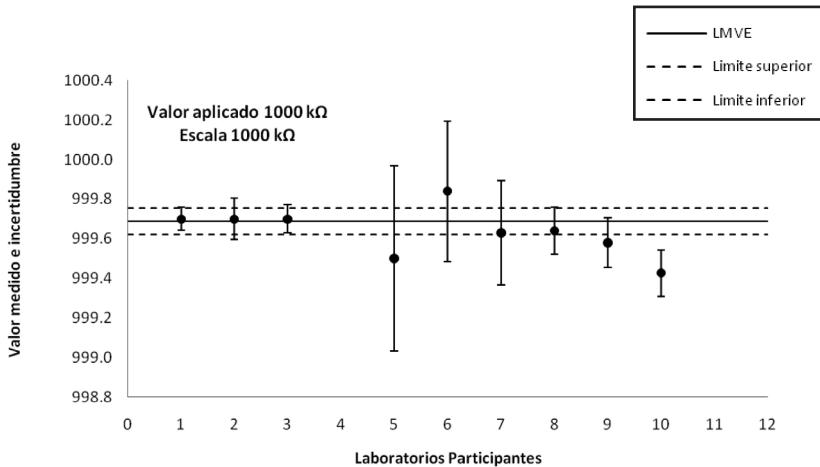

**Figura 16.** Gráfico de resultados de la comparación en 1000 kΩ.

Fuente: (LMVE, 2009).

## CONCLUSIONES

1. La presentación de los datos de esta comparación en forma tabulada y gráfica sirve de referencia para la mejora de los laboratorios participantes.
2. Algunos participantes reportaron incertidumbres iguales o menores que el laboratorio piloto. Estos participantes deben revisar sus cálculos de incertidumbre para comprobar si están subestimando su incertidumbre.
3. Las diferencias en los valores medidos y en las incertidumbres pueden dar a los clientes de los laboratorios participantes una indicación de que deben comparar sus servicios y pedirles mejora en su calidad.
4. Los laboratorios cuyas desviaciones e incertidumbres no son congruentes con los valores de referencia deben realizar acciones de mejora, de acuerdo con la política y criterios para la participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones para los laboratorios, del Ente Costarricense de Acreditación ([www.eca.or.cr](http://www.eca.or.cr)).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ECA (Ente Costarricense de Acreditación). (2006). *ECA-MC-P17 Política y criterios para la participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones para los laboratorios*. Versión 1. Ente Costarricense de Acreditación, San José: Editor.
- HIOKI E.E. (1994) *Manual del usuario Digital hitester 3235*. Japón.

INTECO (Instituto Costarricense de Normas Técnicas). (2005). INTE-ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. (1a ed.) San José: Editor.

INTECO. (2000). INTE ISO/IEC Guía 43-1:2000. Ensayo de aptitud por comparaciones interlaboratorios. Parte 1: Desarrollo y funcionamiento de programas de ensayos de aptitud. San José: Editor.

JCGM 200:2008. Vocabulario internacional de metrología – Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM). BIPM. Traducción al español del VIM 3<sup>a</sup>. [http://www.sim-metrologia.org.br/voca\\_int\\_metro.pdf](http://www.sim-metrologia.org.br/voca_int_metro.pdf)

## SOBRE LOS AUTORES

### **Juan Gómez Valverde**

Ingeniero Electricista, B. Sc.  
Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas  
Instituto Costarricense de Electricidad  
Teléfono: (506) 2283-6642  
Facsimil: (506) 2234-8514  
Apartado postal: 485-2050. San Pedro, Costa Rica.  
Correo electrónico: [jgomezv@ice.go.cr](mailto:jgomezv@ice.go.cr)

### **Harold Sánchez Vargas**

Ingeniero de Sistemas Electrónicos, Ph. D.  
Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas  
Instituto Costarricense de Electricidad  
Teléfono: (506) 2283-4622  
Facsimil: (506) 2234-8514  
Apartado postal: 485-2050. San Pedro, Costa Rica.  
Correo electrónico: [hsanchez@ice.go.cr](mailto:hsanchez@ice.go.cr)